

Toruń, 8 maja 2014 r.

Do wszystkich Wykonawców


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni fizycznej i biologicznej dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) informuje, że w dniu 6 grudnia 2013 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o określenie w jakim wykonaniu mają być wykonane konstrukcje stalowe do stołów laboratoryjnych typu C kształtne czy typu A kształtne – poniżej zdjęcia przywołanych konstrukcji.




Typ C

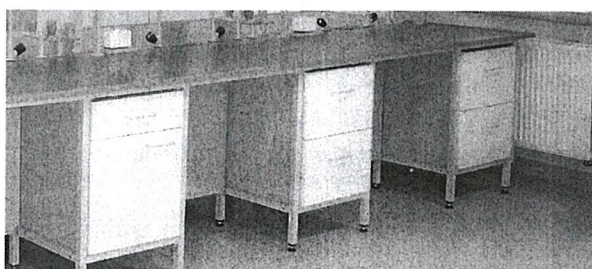


Typ A

Odp. 1. Zamawiający nie przywiązuje wagi do rodzaju kształtu konstrukcji stalowej stołów. Kluczowym elementem jest cena.


2. Prosimy o określenie parametrów dla blatów z ceramiki litej technicznej bez podniesionego brzegu: - czy blaty powinny być wykonane ze spieku ceramicznego w całym swoim przekroju i grubość winny posiadać minimum 19 mm bez podłoża drewnopochodnego z prostym obrzeżem glazurowanym np. wg poniższego zdjęcia:

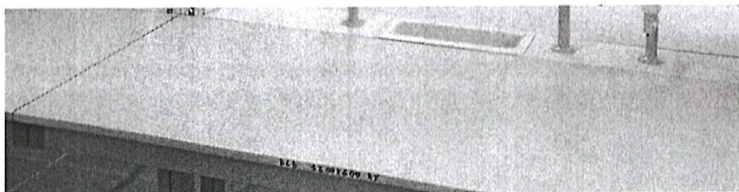

- czy też z blatu z ceramiki litej technicznej o grubości 8 mm plus podłoże drewnopochodne o grubości 25 mm razem grubość 33 mm

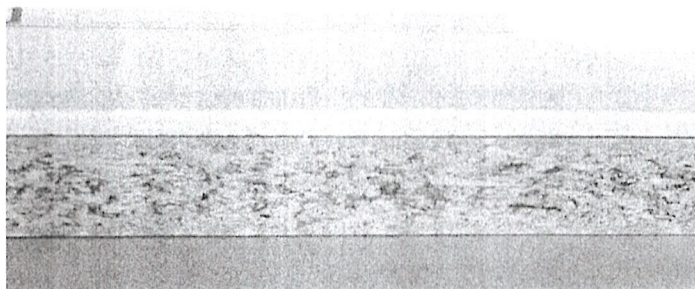

Blat o grubości 8 mm z podłożem drewnopochodnym- przekrój

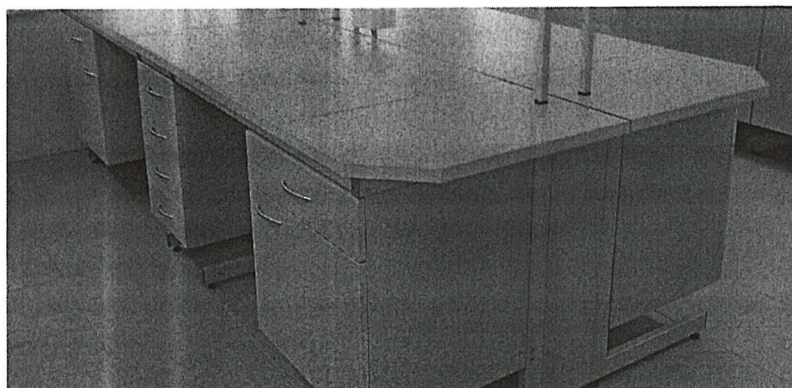

Gotowy blat z obrzeżem prostym prostym z PCV

Odp. 2. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga aby blaty zostały wykonane z ceramiki litej na całej powierzchni tj. w całym swoim przekroju o grubości minimum 19 mm.

3. Czy meble laboratoryjne powinny posiadać atest higieniczny wydany przez niezależną jednostkę badawczą i czy wymieniony atest dołączyć do oferty?

Odp. 3. Meble laboratoryjne nie muszą posiadać atestu higienicznego, więc Zamawiający nie stawia wymogu załączania takiego dokumentu do oferty.

4. Czy blaty ceramiczne powinny posiadać atest higieniczny i czy wymieniony atest dołączyć do oferty?

Odp. 4. *Blaty ceramiczne nie muszą posiadać atestu higienicznego, więc Zamawiający nie stawia wymogu załączania takiego dokumentu do oferty.*

5. Czy w zakresie wymagań że stoły laboratoryjne muszą być zgodne obowiązującymi normami PN –EN 13150:2004 - Stoły robocze dla laboratoriów, wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz PN-EN 14727-2006 Meble do przechowywania - wykonawca powinien posiadać certyfikat wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą uprawnioną w zakresie badań tego typu wyrobów?

Odp. 5. *Nie. Zamawiający nie stawia takiego warunku. Zamawiający dopuszcza deklarację zgodności z normą wystawioną przez producenta.*

6. Czy producent mebli laboratoryjnych powinien posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych oraz urządzeń laboratoryjnych, wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów jakości w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) –i ważny certyfikat ISO 9001:2008 należy załączyć do oferty?

Odp. 6. *Zamawiający nie wymaga aby producent mebli posiadał certyfikat systemu jakości ISO 9001:2008, więc Zamawiający nie stawia wymogu załączania takiego dokumentu do oferty.*

7. Czy Wykonawca mebli laboratoryjnych musi posiadać certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 w systemie zarządzania środowiskiem oraz posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007 i czy wymienione certyfikaty należy załączyć do oferty?

Odp. 7. *Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca mebli laboratoryjnych posiadał certyfikatu zgodności z normą ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007, więc Zamawiający nie stawia wymogu załączania tych dokumentów do oferty.*

8. Pracownia fizyczna , pozycja 4 - prosimy o podanie ilości zamawianych stanowisk zlewozmywakowych.

Odp. 8. *Zamawiający w ramach wykonania pracowni fizycznej w pozycji 4 wymaga - 1 sztuki stanowiska zlewozmywakowego.*

9. Pracownia biologiczna , pozycja 2 - co zamawiający ma na myśli pisząc : szafka x 1 600 mm z " 4 szufladami z półką w środku". Czy w/w zapis należy traktować jako omyłkę pisarską.

Odp. 9. *Zamawiający w ramach wykonania pracowni biologicznej w pozycji 2, oświadcza, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Zapis: „szafka x 1 600 mm” należy interpretować jako szafka x 1 sztukę o wymiarach 600 mm. W każdym miejscu formularza ofertowego lub Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, gdzie znajduje się zapis typu „asortyment x 1 600 mm, należy to interpretować jako asortyment x jego ilość, wymiar.*

10. Pracownia biologiczna poz. 3 - zamawiający podaje dwa różne zestawy wymiarów stołu przyściennego: 2650 x min 750 x 900 oraz 2650 x 500 x min 700. Który zestaw jest obowiązujący?

Odp. 10. Zamawiający w ramach wykonania pracowni biologicznej w pozycji 3 wyjaśnia, że wymiary 2650 x min 750 x 900 dotyczą stołu przyściennego a wymiary 2650 x 500 x min 700 dotyczą szafki wiszącej nad stołem przyściennym.

11. Czy Zamawiający dopuści deklaracje zgodności wystawionej przez wykonawcę poświadczającej, że oferowane i dostarczone meble laboratoryjne, stoły laboratoryjne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami ?

Odp. 11. Tak, Zamawiający dopuści deklaracje zgodności wystawione przez Wykonawcę, poświadczające, że oferowane meble są zgodne z obowiązującymi normami.

12. Czy określenie przez Zamawiającego – blat z ceramiki litej technicznej odnosi się do ceramiki technicznej laboratoryjnej o grubości 8mm naklejany na podkład drewnopodobny o gr25mm co nam daje całkowitą grubość blatu 33mm, czy ceramiki lita techniczna monolityczna na całej swojej grubości 19-20mm bez płyty nośnej ?

Odp. 12. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga aby blaty zostały wykonane z ceramiki litej na całej powierzchni tj. w całym swoim przekroju o grubości minimum 19 mm.

13. Mam pytanie co do: nośniki Windows i Office – mogą to być kopie ?

Odp. 13. Zamawiający w części 4 pkt. 1 "Komputer przenośny z oprogramowaniem i akcesoriami" wymaga zainstalowania oprogramowania, m.in. systemu operacyjnego Win7 Pro64bit oraz MS Office 2013 H&B, a także dostarczenia odpowiednich nośników zawierających to oprogramowanie. Zamawiający nie specyfikuje czy muszą to być oryginalne nośniki zawierające to oprogramowanie wraz z odpowiednimi licencjami czy też kopie oprogramowania kompatybilne z licencjami na to oprogramowanie dostarczonymi również przez Wykonawcę w ramach postępowania. Tym samym, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia na nośniku odpowiednich kopii oprogramowania kompatybilnych z zainstalowanym oprogramowaniem na komputerach przenośnych oraz licencjami do tego oprogramowania.

Z poważaniem,


DIREKTOR
Monika Wiśniewska